

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
05.01.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GAZ VAKUM ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	VAKUM MANOMETRESİ (REGÜLATÖR)	56 Adet	
2	TEKLİ OKSİJEN FLOWMETRESİ	34 Adet	
	PEDİATRİ HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ SERVİSİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **17/01/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

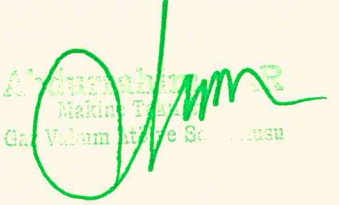
[illegible]

- Ahmed Zaki KAR
Maklaci Mah. Akari
Gaz Vakum A. 10.1 Korundusu

TEKLİ OKSİJEN FLOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Merkezi sistemden gelen OKSİJEN Gazını regüle edip nemlendirerek hastaya verilmesini sağlamaya uygun olmalıdır.
2. Merkezi sistem bağlantı jakı İNGİLİZ (BS) normuna uygun olup krom kaplı pirinç malzemeden imal edilmiş ve uzun ilaveli olmalıdır.
3. Flowmetre ayar skalası silinmez baskılı 15 lt/dk 1 lpm artışlı olarak dizayn edilmiş olmalı, kalıcı bir şekilde oksijen simgesi ve kalibrasyon sıcaklığı belirtilmiş olmalıdır.
4. Oksijen flowmetresinin gövdesi pirinç ham maddeden üretilmiş ve 40 mikron krom-nikel kaplı olmalıdır.
5. Oksijen debi ayar mili paslanmaz çelikten olup istenilen akışın kolay sağlanması için kapatıcı uç kısmı yanmaz plastik malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. Oksijen flowmetresi nemlendirme kabı 150 ml polikarbonat malzemeden imal edilmiş olup darbe ve kırılmalara karşı mukavim olmalıdır. Maksimum ve minimum srril su seviyesi , üretici firma ismi yağ ve ateşten korunması için uyarı işaretleri ve yazıları mevcut olmalıdır. 134°C derecede steril edilebilmelidir. Sterilizasyon sıcaklığı nemlendirme kabı alt kısmında silinmeyecek şekilde kabartma halinde belirtilmelidir.
7. Oksijen flowmetresi nemlendirme kabı pirinç gövde üzerine vidalı el ile montaj edilip çıkarılabilmelidir. Bağlantı somunu 12 köşe 9/16 dış ölçüsünde olmalıdır. Kırılmalara karşı mukavim olmalıdır. Kendi eksenini etrafında dönme imkanına sahip olmalıdır. Pirinç gövdeye bağlantı somunu ve bağlantı mili paslanmaz çelik (krom) hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
8. Oksijen flowmetre kabı kapağı yanmaz plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Üzerinde nemlendirilmiş oksijeni hastaya girişini sağlayan paslanmaz çelikten (krom) imal edilmiş hortum yeri olmalıdır. Kavanoz içerisinde gaz sıkışmasını önlemek amacı ile kavanoz kapağı üzerinde gaz tahliye emniyet sibobu olmalıdır. Nemlendirme kapağı ile kavanoz arasında sızdırmazlık elemanı bulunmalıdır.
9. Oksijen flowmetresi merkezi sistemden gelen OKSİJEN gazını filtrasyon yaparak hastaya gönderilmesini sağlayan 134°C derecede steril edilebilecek olmalıdır.
10. Oksijen debi ayar düğmesi üzerinde firma ismi ve açma- kapama yönü silinmeyecek şekilde çöktürme olarak belirtilmelidir.
11. Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
12. Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı bulunmalıdır.

13. Üretim ve imalat hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
14. Ücreti karşılığında 10 (on) yıl süreyle yedek parça temini yapılabilmelidir.
15. İmalatçı firmalar ISO 9001:2015 hizmet yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
16. Mevcut merkezi medikal gaz sistemine uyumlu olmalıdır.


Abdurrahman R.
Makine Teknolojisi
Gaz Valvum Atama Sorumlusu


Prof. Dr. Duran AKOLAN
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Erciyes Tıp Fakültesi
Erciyes Hastanesi