

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
22.02.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (KARDİYOLOJİ)KORONER ANJİOGRAFİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KORONER SINÜS KATETERİ	5 ADET	
2	MANİFOLD (BAĞLANTI SETİ OPAK MADDE İÇİN VALFLİ	1000 ADET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK,NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 24/02/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



STEERABLE DECAPOLAR KORONER SİNÜS KATETERİ

1. Koroner sinüse ulaşarak elektrofizyolojik çalışma yapılmasına olanak sağlayan tasarımda olmalıdır.
2. Kateterler Decapolar olmalıdır.
3. Kateterlerin shaft çapı 6 French olmalıdır.
4. Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır.
5. Medium, Large, X-Large, Medium/Large olarak 4 curve seçeneği veya multipurpose olmalıdır.
6. Kateterlerin toplam uzunluğu en az 110 cm olmalıdır.
7. 6 French'olan ürün bi-directional veya uni-direksiyonel curve yapabilmeli, 2 veya 2-5-2 veya 2-8-2 veya 5mm elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır.
8. Distal elektrodu en az 1 mm olmalıdır.
9. Band elektrod genişliği en az 1mm olmalıdır.
10. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmıştır. Handle ' in simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygundur.
11. Curve vermek için handle kısmının önünde yer alan aplikasyon ring'ine sahip olmalıdır.
12. Aplikasyon ringine itme ve çekme manevraları, uygulanarak kontrol edilebilmelidir.
13. Verilen curve'ün kaybolmaması için kateterin kilit mekanizması olmalıdır.
14. 1,5m veya 2m uzunlukta bağlantı kablo seçenekleri olmalıdır.
15. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
16. Ölçüsü biten ürünler başka Ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
17. Fabrika üretiminin durması ya da başka benleri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

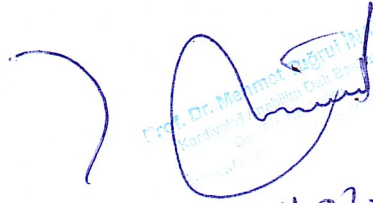
11.02.2022

BAĞLANTI SETİ OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ

1. Manifold şeffaf yapıda olmalıdır.
2. Manifold da birbirinden bağımsız üç adet musluk bulunmalıdır.
3. Manifold, hastanın hem sağma hem de soluna yerleştirilebilecek şekilde olmalıdır.
4. Manifold, en az, 500 PSI basınç'a dayanıklı olmalıdır.
5. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amacıyla line bağlantı yerleri çevirmeli olmalıdır.
6. Koroner Anjio enjektörü basınca dayanıklı şeffaf yapıda olmalıdır.
7. Koroner Anjio enjektörü 12cc hacminde, 2cc stoperli olmalıdır.
8. Koroner Anjio enjektörü hazne kısmında 2 Adet, Piston proksimalinde ise 1 Adet parmak geçirme yerleri olmalıdır.
9. Koroner Anjio enjektörü standart luer locklu olmalıdır.
10. Set içerisinde en az 1 adet serum seti ve 1 adet en az 100cm uzunluğunda uzatma line i olmalıdır.
11. Set steril poşetlerde, en az 1(bir) yıl miatlı olmalıdır.
12. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
13. CE onaylı olmalıdır.
13. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
15. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.



M. Dr. 2022