

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
22.02.2022


SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİRİMİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	AKÜLÜ HAVALANDIRMA FANI	1 Adet	
	Bilgi İçin : AFET ve ACİL YÖNETİM BİRİMİ (Mehmet ESKİTAŞ) Tel : (0.352) 207 66 66 – Dahili : 22423		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **09/03/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

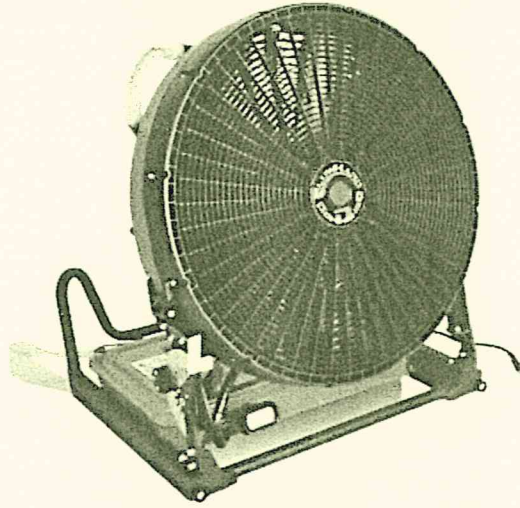

AKÜLÜ HAVALANDIRMA FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz; hem şebeke elektriğiyle, hem de elektriğin bulunmadığı yerlerde kendi aküsü ile çalışabilecektir.
2. Cihazın bataryaları, Li-Ion tipinde olacaktır.
3. Havalandırma fanı, pozitif basınçlı tip olacaktır. Hava basma kapasitesi en yüksek devirde en az 19.300 m³/saat olacaktır. Fan Boyutu en az 20" olacaktır.
4. Cihaz 19.300 m³/saatte en az 45 dakika, 14.000 m³/saatte en az 4 saat, çalışabilecektir.
5. Cihaz kendi üzerindeki fiş ile 220 V şebekeden veya jeneratörden direkt olarak şarj edilebilecektir.
6. Cihazın üzerinde batarya şarj durum göstergesi olacaktır. Bu göstergede yeşil, sarı ve kırmızı renkli LED'ler ile birlikte şarj durumu anlaşılabilir olacaktır.
7. Cihaz çalışma yerine getirildiğinde, hiçbir elektrik kaynağına ihtiyaç duymaksızın bir düğme ile çalışmaya başlayabilecektir. Gerektiğinde direkt 220 VAC elektrik prizinden de çalışabilecektir.
8. Cihazın tam şarj süresi en fazla 3,5 saat olacaktır. Cihaz en fazla 3 saat içinde %0-%90 arasında şarj olabilecektir. Cihazın Batarya ömrü en az 480 tam şarj olacaktır.
9. Cihaz taşınabilir tip olacak ve ağırlığı dahili bataryası ile birlikte 23 kg'ı aşmayacaktır.
10. Kolay taşınabilmesi ve/veya aracın içine yerleştirilebilmesi için katlanabilir tip olacak ve katlandığında ebatları 534x534x248 mm'yi aşmayacaktır.
11. Havalandırma fanının yönü 0° ile 180° arasındaki eğimlere ayarlanabilecektir.
12. Akülü havalandırma fanı IP67 koruma sınıfına sahip olacaktır.
13. Havalandırma Fanının üzerinde 1 adet açısı ayarlanabilir aydınlatma LED'i olacaktır.
14. Havalandırma fanının omuz taşıma askı kayışı bulunacaktır.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi
Mehmet ESKİTAŞ

M. ESKİTAŞ