

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.02.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	BOŞ GÖZ DAMLALIĞI 10 CC	1000 ADET	
2	AHMED GLOKOM VALVİ İMPLANTI (ERİŞKİN BOY)	5 ADET	
3	AHMED GLOKOM VALVİ İMPLANTI (ÇOCUK BOY)	5 ADET	
4	VITREORETİNAL SWEEPER (ELMAS UÇLU)	5 ADET	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK,NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 17/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

BOŞ GÖZ DAMLALIĞI ŞARTNAMESİ

- 1- 10 cc ebatlarında ve plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Sızdırma yapmayan ve uzun süre dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Numune klinik tarafından görüldükten sonra karar verilecektir.

Y.C.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. Faik HOROZOĞLU
Dip. Te. No: 98748
Göz Hastalıkları A.D.

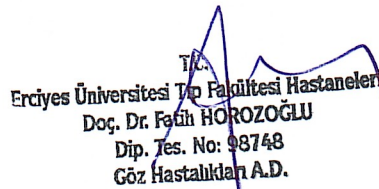
1- AHMED GLOKOM VALVİ İMPLANTI ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme intraoküler basıncı normal seviyeye indirebilecek aynı adla anılan valf sistemini içermelidir.
- 2- Malzeme her türlü yüksek basınçlı glokomda özellikle (neovasküler glokom, üveitik glokom, konjenital glokomda) korneal transplantasyonlarda transplant ile birlikte kullanılabilirlikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Malzeme tek aşamalı basit cerrahi müdahale ile implant edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Valf gövdesi: Silikon gövde, drenaj tüpü: Silikon, Valf: silikon, elastomer membrandan imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Ebat genişliği: 13.0 mm, kalınlık: 0.9 mm, uzunluk: 16.0 mm, tüp uzunluğu, 25.0 mm, yüzey alanı: 184.0 mm olmalıdır.
- 6- Malzeme son obstructive valf sistem teknolojisi ile aşırı drenajı engelleyecek ön kamara colapsını önleyecek sisteme sahip olmalıdır.
- 7- Yüklenici firma gerektiğinde yetişkin formunu, pediatrik formuyla değiştirebilme garantisini vermelidir.
- 8- Yüklenici firma gerekli hastalar için yüzey alanını 360 mm ye çıkaran biplate formu ahmed valfine bağlayan bağlantı tüpünü ücretsiz vermeyi taahhüt edebilmelidir.
- 9- Yüklenici firma gerekli hastalarda pars plana uygulamaları için pars plana clipi ücretsiz vermeyi taahhüt edebilmeli.
- 10- Cihaz orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 11- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
- 12- Yüklenici firma malzemenin miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmayan malzemeleri en az bir yıllık miada sahip ürünle değiştirecektir.

2- VİTREORETİNAL SWEEPER (ELMAS UÇLU)

1. Tek kullanımlık olmalıdır, gövde elden kaymayı engellemek amacı ile pürüzlü yapıda olmalıdır.
2. Paket üstünde kod numarası ce işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır,
3. Sweeper ucu bozulma kırılma ve yamulmaya karşı ileri geri hareket mekanizmalı olmalıdır, bu durum vazgeçilmez bir özelliktir,
4. Alet ucu elmas tozu ile kaplanmış olmalıdır,
5. Teklif edilen ürün steril çift blister ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde işaretler olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün elcik bölümü 360 derece tutulabilme özelliğine sahip ve geniş açılı non kontakt mercek sistemleri mekanizmasına (Eye-Boss, Biom, Ruw, Resight vb.) çarpmaması için kısaltılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
7. 25 gauge ve 0,5 mm ölçüsünde olmalıdır.


Doç. Dr. Duygu GULMEZ SEVİM
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tesc. No: 145591
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


T.C.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. Fatih HOROZOĞLU
Dip. Tesc. No: 98748
Göz Hastalıkları A.D.