

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
28.03.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D.. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no |                                                                                                                                                                                                     | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT                                                                                                                                                             | 10 ADET |              |
| 2    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 3    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 4    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 5    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 6    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 7    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 8    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 9    |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 10   |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR                                                                                                                                                                   |         |              |
|      | <b>TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN<br/>TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR</b>                                                                                                |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir. |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                             |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                    |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                       |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                           |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                          |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                    |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                             |         |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                        |         |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |         |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 06/04/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

**TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR)  
KR3001 - KV4001 - GR3001**

- 1- Torasik aorta bölgesinde kullanılmak üzere, polietilen teraftalat(PET-DACRON) greft ile kaplanmış, self expandable(kendiliğinden genişleyen) nitinol alaşımdan oluşan bir stent olmalıdır.
- 2- 36 mm'ye kadar proksimal çap değerine sahip bir torasik greft stent için, delivery(teslimat) sistemi en fazla 18 F(6mm), 36 mm den büyük çaplar için en fazla 20 F ve hidrofilik kaplama olmalıdır.
- 3- Delivery(teslimat) sisteminin greft stent bulunan bölümünde , outer sheath(dış kılıf) içinde ,yumuşak bir PET(dacron) kumaştan imal edilmiş inner sheath(iç kılıf) olmalıdır. Bu kılıf ile torasik aorta geçilebilmeli bu sayede, atravmatik ve daha kolay konumlandırma yapılabilmelidir.
- 4- Graft stent, emniyetli ve doğru konumlanması için bare metal(çıplak metal) stent, uç yakalama-bırakma mekanizması sayesinde sabit bir şekilde durmalıdır.
- 5- Proksimalde 4(dört), ortasında 1(bir), distalinde 2(iki) adet radyoopak marker(işaretleyici) bulunmalıdır.
- 6- Torasik aorta bölgesinde mükemmel uyum için taper(konik) ve straight(düz) seçenekleri olmalıdır.
- 7- Taper(konik) seçeneklerde proksimal çap seçenekleri 30 mm ile 42 mm arasında, uzunluk seçenekleri ise 140 mm ile 200 mm arasında seçilebilmelidir.
- 8- Straight(düz) seçeneklerde proksimal çap seçenekleri 20 mm ile 44 mm arasında, uzunluk seçenekleri ise 45 mm ile 100 mm arasında seçilebilmelidir.
- 9- Torasik greft stentin ana gövdesinin açılması ve serbest bırakılması son derece güvenilir ve kolay bir mekanizmayla yapılabilmelidir.
- 10- Graft stent, orijinal ambalajında steril olarak bulunmalıdır.

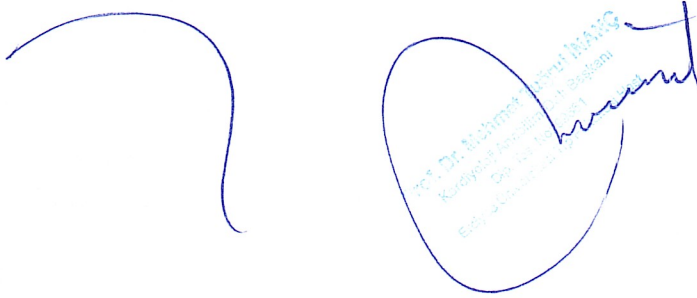

Handwritten signature and stamp. The stamp is a circular official seal of the Ministry of Health of the Republic of Turkey, containing the text 'Dr. Mehmet Akif İNANÇ', 'Kardiyovasküler Hastalıklar Bölümü', 'Göğüs Hastalıkları', and 'Etiler, Beşiktaş/İstanbul'. The signature is written in blue ink over the stamp.