

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
29.04.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ÜROLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	DOUBLE J KATETER 4.8 FR 20 CM	30 ADET	
2	TUR SETİ PUARLI	500 ADET	
3	DOUBLE J STENT SET 6FR 26 CM	100 ADET	
4	DOUBLE J STENT SET 6FR 28 CM	100 ADET	
5	DOUBLE J STENT SET 7FR 28 CM	200 ADET	
6	DOUBLE J STENT SET 8FR 28 CM	50 ADET	
7			
8			
9			
10	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 18/05/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

2- 4,8FR 20CM DOUBLE J STENT


1. Stent, 12 ay vücutta kalabilmelidir.
2. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
3. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
4. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
5. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
6. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.035 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
7. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
8. 4.8Fr kalınlığında ve 12,16,20,24 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
14. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
15. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

5- ARTROSKOPİ SETİ PUARLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set PVC den mamul olmalıdır.
2. Hortum Y konnektör sayesinde iki uca ayrılmalı, her iki uçta açma/kapama klipsleri ve hava girişsiz delme uçları bulunmalıdır.
3. Y konektörden sonraki kısım üzerinde de 1(bir) adet açma/kapama klipsi olmalıdır.
4. Hat üzerinde hızlı doldurma puarı bulunmalıdır.
5. Yumuşak hortumlu proksimal uç olmalıdır.
6. Proksimal ucun birleştiği yerde konektör ve konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.
7. Toplam uzunluk 220 cm olmalıdır.
8. Tekli steril poşetlerde bulunmalıdır.
9. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
10. Numune vermeyen firma değerlendirilmeyecektir.
11. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

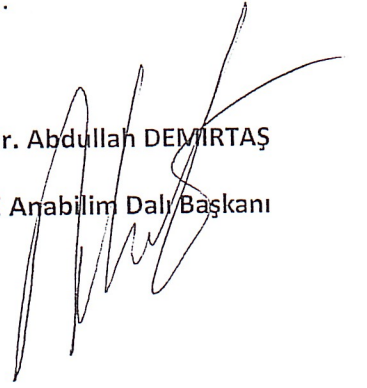

1- 6FR 26CM DOUBLE J STENT

1. Stent 6Fr kalınlığında ve 26cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Double J Stent, insan vücuduna zarar vermeyecek, insan vücudu içerisinde uzun süre kalabilecek ve idrar ile temas sonrasında bozulmayacak materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Stentin her iki ucu açık olmalıdır.
4. Stentin üstünde delikler olmalıdır, diğer ucu incelemek gelmelidir.
5. Stent 0,038inç kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilmelidir.
6. Stent içerisinde 1 adet 6Fr 26cm stent yerleştiricisi ve düz uçlu 0.038inç kılavuz tel olmalıdır.
7. Ürün steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar bir adet numune vereceklerdir.
9. Ürün radyopak olmalıdır.
10. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
11. Numune vermeyen firma değerlendirilmeyecektir.
12. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.
13. Her ürün paketi üzerinde stentin kalınlığı (Fr), uzunluğu (cm) ve kılavuz telin kalınlığı (inh) olarak belirtilmelidir.

2- 6FR 28CM DOUBLE J STENT

1. Stent, 12 ay vücutta kalabilmelidir.
2. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
3. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
4. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
5. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
6. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.038 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
7. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
8. 6Fr kalınlığında ve 12,16,24,28 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
14. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
15. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

PROF.DR. ABDULLAH DEMİRTAŞ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

2 - 7FR 28CM DOUBLE J STENT

1. Stent, 12 ay vücutta kalabilmelidir.
2. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
3. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
4. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
5. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
6. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.038 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
7. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
8. 6Fr kalınlığında ve 12,16,24,28 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
14. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
15. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

4 -8FR 26CM DOUBLE J STENT

1. Stent 8Fr kalınlığında ve 28cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Double J Stent, insan vücuduna zarar vermeyecek, insan vücudu içerisinde uzun süre kalabilecek ve idrar ile temas sonrasında bozulmayacak materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Stentin her iki ucu açık olmalıdır.
4. Stentin üstünde delikler olmalıdır, diğer ucu inceleyerek gelmelidir.
5. Stent 0,038inç kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilmelidir.
6. Stent içerisinde 1 adet 8Fr 26cm stent yerleştiricisi ve düz uçlu 0.038inç kılavuz tel olmalıdır.
7. Ürün steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar bir adet numune vereceklerdir.
9. Ürün radyopak olmalıdır.
10. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
11. Numune vermeyen firma değerlendirilmeyecektir.
12. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.
13. Her ürün paketi üzerinde stentin kalınlığı (Fr), uzunluğu (cm) ve klavuz telin kalınlığı (inh) olarak belirtilmelidir.

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı