

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
17.05.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	BİLİYER STENT SET (10CM 10 FR – 7CM 10FR – 5 CM 10FR)	100 ADET	
2	SFİNKTERATOM ÜÇ LÜMENLİ	200 ADET	
3	BİLİYER DİLASYON BALONU 12-13,5-15 MM KADEMELİ)	2 ADET	
4	BİLİYER DİLASYON BALONU 10-11-12 MM KADEMELİ)	2 ADET	
5	BİLİYER STENT KAPLI / ÇIKARILABİLİR (8MM UZUNLUK 60MM)	2 ADET	
6	BİLİYER STENT KAPLI / ÇIKARILABİLİR (10MM UZUNLUK 40MM)	2 ADET	
7	BİLİYER STENT KAPLI / ÇIKARILABİLİR (10MM UZUNLUK 60MM)	2 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			


NOT : Teklif mektuplarının en geç **23/05/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

SFİNKTEROTOM (3 lümen)

1. Enjeksiyon kılavuz tel ve kesme teli için 3 ayrı lümenli olmalıdır.
2. Kılavuz teli üzerindeyken enjeksiyon yapılabilirdir.
3. Distal uęta radyopak endoskopik marker olmalıdır.
4. Kateter 200cm uzunluęunda olmalıdır
5. Kesme teli 30 mm. uzunluęunda olmalıdır ve işlem sırasında kanamaya neden olmamalıdır.
6. 035'' kılavuz tel ile uyumludur.
7. Distal ucu önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
8. Kesici tel monofilament tipinde ve 20-30 mm uzunluęunda olmalıdır.
9. Plastik handle üzerinde active kablo bağlantısı ve sfinkterotomun distal uç kısmının ne kadar büküldüğünü gösteren ölçü skalası olmalıdır.
10. Numune gelen malzeme işlem esnasında kullanılacaktır.
11. Miadı depoya tesliminden itibaren 2 yıl olmalıdır.

BİLİARY PLASTİK STENT SET ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen stent set 2.8 mm kanaldan geçebilmelidir.
- 2- 0.35 kılavuz telle uyumlu olmalıdır.
- 3- Teklif edilen stent set 10 fr olmalıdır. (ihtiyaca göre değıştirilebilmelidir.)
- 4- Teklif edilen stent boyları 10 cm ,7cm ,5 cm olmalıdır.seçilen firmaya bu uzunluktaki stentlerin miktarları belirtilip ona göre temin yapılmalıdır.
- 5- Stent proksimalinde ve itici kateter radyoopak markerlar bulunmalıdır.
- 6- Teklif edilen stent filoroskopi altında görülebilmelidir.
- 7- Teklif edilen stent set tek kullanımlık olmalıdır.
- 8- Teklif edilen stent set steril pakette olmalıdır.
- 9- Elimizdeki stentler ihtiyaca göre farklı boy ve genişlikteki stentlerle değıştirilebilmelidir.

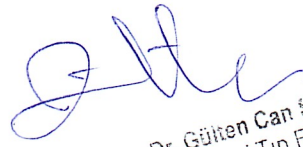

Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007

-BİLIARY DİLATASYON BALONU KADEMELİ 12-13,5-15MM

- 1-BALON KATETERİ İÇERİSİNDE İSTENİLDİĞİNDE ÇIKARILABİLİR 0.035 HİDROFİLİK KAPLI KILAVUZ TEL BULUNMALIDIR.
- 2-KATETER UZUNLUĞU EN AZ 180 CM OLMALIDIR.
- 3-KATETER ÇAPI 7 F OLMALIDIR.
- 4-KATETERİN BALONDAN SONRAKİ UÇ KISMI SİLİKONDAN MAMÜL OLUP DOKUYA ZARAR VERMEYECEK YUMUŞAKLIKTA OLMALIDIR.
- 5-2.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 6-UCU İNCELEREK SONLANMALIDIR.
- 7-BALONUN HER İKİ UCUNDA FLOROSKOPİ ALTINDA GÖRÜLEBİLİR RADYOOPAK MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-BALON KADEMELİ OLARAK ŞİŞİRİLEBİLMELİDİR.
- 9-BALON ÇAPI 12-13,5-15 MM OLMAK ÜZERE KADEMELİ OLMALIDIR.
- 10-BALON UZUNLUĞU EN FAZLA 30 MM OLMALIDIR.
- 11-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
- 12- ÜRÜN KATETERİ ÜZERİNDE BALON ÇAPLARI SİLİNMEYECEK BİR ŞEKİLDE YAZILI OLMALIDIR.

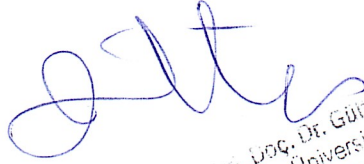
-BİLIARY DİLATASYON BALONU KADEMELİ 10-11-12 MM

- 1-BALON KATETERİ İÇERİSİNDE İSTENİLDİĞİNDE ÇIKARILABİLİR 0.035 HİDROFİLİK KAPLI KILAVUZ TEL BULUNMALIDIR.
- 2-KATETER UZUNLUĞU EN AZ 180 CM OLMALIDIR.
- 3-KATETER ÇAPI 7 F OLMALIDIR.
- 4-KATETERİN BALONDAN SONRAKİ UÇ KISMI SİLİKONDAN MAMÜL OLUP DOKUYA ZARAR VERMEYECEK YUMUŞAKLIKTA OLMALIDIR.
- 5-2.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 6-UCU İNCELEREK SONLANMALIDIR.
- 7-BALONUN HER İKİ UCUNDA FLOROSKOPİ ALTINDA GÖRÜLEBİLİR RADYOOPAK MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-BALON KADEMELİ OLARAK ŞİŞİRİLEBİLMELİDİR.
- 9-BALON ÇAPI 10-11-12 MM OLMAK ÜZERE KADEMELİ OLMALIDIR.
- 10-BALON UZUNLUĞU EN FAZLA 30 MM OLMALIDIR.
- 11-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
- 12- ÜRÜN KATETERİ ÜZERİNDE BALON ÇAPLARI SİLİNMEYECEK BİR ŞEKİLDE YAZILI OLMALIDIR.


Yrd. Doç. Dr. Güten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007

BİLYARY STENT TAMAMI KAPLI ÇIKARILABİLİR

1. STENT SELF EXPANDABLE OLMALIDIR.
2. STENT MATERYALİ NİTİNOL OLMALIDIR.
3. STENT FLEXİBLE OLMALIDIR.
4. STENT TAMAMI KAPLI OLMALIDIR.
5. STENT ÇAPI 10 MM, STENT UZUNLUKLARI 4-6 CM OLMALIDIR.
6. BİR TANESİ 8 MM ÇAPINDA, UZUNLUĞU 60 MM OLMALIDIR.
7. VAKA ESNASINDA STENTİN % 80 LİK KISMI AÇILMIŞ OLSA BİLE TEKRAR İNTRUDUCER İÇERİSİNE TOPLANABİLMELİDİR.
8. STENT İNTRUDUCERİ 3 MM (9 F) ÇAPINDA VE ÇALIŞMA UZUNLUĞU EN AZ 180 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
9. STENTİN DİSTAL VE PROXİMAL UÇLARI KONİK ŞEKLİNDE GENİŞLEMELİ
10. STENTİN RADYAL FORSU YÜKSEK OLMALIDIR.
11. UYGULAMA APARATI ÜZERİNDE GÜVENLİK KİLİDİ BULUNMALIDIR.
12. 0.035 KILAVUZ TEL KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.
13. UYGULAMA APARATINDA ENJEKSİYON LÜMENİ BULUNMALIDIR.
14. STENT ÜZERİNDE EN AZ 8 ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
15. ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.
16. ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
17. STENTİN HER İKİ UCUNDA İP BULUNMALIDIR.



Dr. Doç. Dr. Günen Can SEZGİN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 115007