

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
30.05.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GASTROENTEROLOJİ B.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ŞİFINKTERATOM İĞNE UÇLU	20 ADET	
2	FİLELİ SNARE 2,30 CM	60 ADET	
3	SKLEROTERAPİ İĞNESİ3,30 CM	100 ADET	
4	BİYOPSİ FORSEPSİGASTROSKOPİK	100 ADET	
5	BİYOPSİ FORSEPSİ KOLONOSKOPİK	15 ADET	
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			


NOT : Teklif mektuplarının en geç **08/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.


SFINKTEROTOM İğne uçlu ve üçlümenli sfinkteretom

1. Enjeksiyon, kılavuz tel ve kesme teli için 2 ayrı lümenli olmalıdır.
2. Kılavuz tel üzerinde iken enjeksiyon yapılabilmelidir.
3. Distal ucu radyoopak olmalı ve pozisyon belirleyici renkli radyoopak çizgileresahip olmalı
4. İğne uzunluğu 4 veya 6 mm olmalıdır.
5. "035" kılavuz 260 cm tel ile uyumlu olmalıdır.
6. Kılavuz tel değişim kanalı veya orifisi kateterin distal kısmında olmalıdır.
7. Kateter boyunca doktorun klavuz tel kontrolünü sağlayacağı açık bir lümen bulunmaktadır.
8. Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
9. DİŞ çapı 2.8 çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
10. Kateter kalınlığı 7FR den 5 FR'e incelmelidir.
11. Miadi depoya teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

Fileli Polip Çıkarma Snare

1. Yabancı cisim ve polip çıkarmaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Gastroskopik olarak 160cm kolonoskopik olarak 230cm verilebilmelidir.
3. Kilitlenebilir handle yapısına sahip olmalıdır.
4. Snare kementleri 3x6cm olmalıdır.
5. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
6. File, polip ve yabancı cisim için güçlü olmalıdır.
7. Handle bölgesi şafta sabit olmalıdır.
8. Ürün FDA belgesine sahip olmalıdır.


Prof. Dr. Sebnem GURSOY
İç Hastalıkları A.D. Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. No: 84006 - İnt. No: 54214
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uygundur


Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007
Uygundur

-SCLEROTERAPİ İĞNESİ

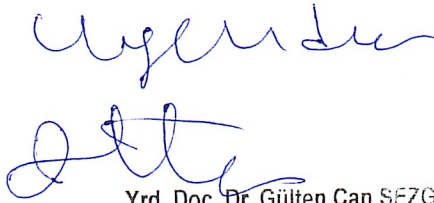
- 1-KATETER ÇAPI 2.3 MM OLMALIDIR.
- 2-KATETER UZUNLUĞU EN AZ 230 CM OLMALIDIR.
- 3-KATETERİN UÇ KISMI METAL KORUMALI OLMALIDIR.
- 4-İĞNE UZUNLUĞU 4 VE 5 MM OLMAK ÜZERE ALTERNATİFLİ OLMALIDIR. İSTENİLEN MİKTARLARDA TESLİMAT YAPILCAKTIR.
- 5-HANDLE KISMI OLMALIDIR.
- 6-KİLİTLENEBİLİR HANDLE A SAHİP OLMALIDIR.

DİSPOSABLE BİYOPSİ FORSEPSİ GASTROSKOPİK İĞNELİ

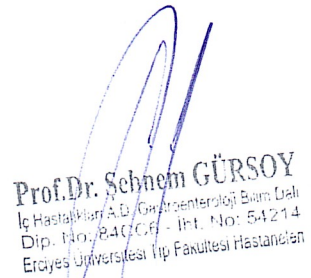
- 1-ÜRÜN KATETERİ EN FAZLA 2.3 MM DIŞ ÇAPA SAHİP OLMALIDIR.
- 2-ÜRÜN KATETERİ EN AZ 180 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 3-ÜRÜN OVAL TİP İĞNELİ OLMALIDIR.
- 4-FORSEPS KAPAKÇIKLARI EN AZ 6.7 MM GENİŞLİĞİNDE AÇILABİLMELİDİR.
- 5-FORSEPS KAPAKÇIKLARI KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.
- 6-FORSEPS ŞAFTI PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP ÜZERİ KAPLI OLMALIDIR.
- 7-KATETER KAPLAMASI ÜZERİNDE POZİSYONLANDIRMA MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-2.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 9-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.

DİSPOSABLE BİYOPSİ FORSEPSİ KOLONOSKOPİK İĞNELİ

- 1-ÜRÜN KATETERİ EN FAZLA 2.3 MM DIŞ ÇAPA SAHİP OLMALIDIR.
- 2-ÜRÜN KATETERİ EN AZ 230 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 3-ÜRÜN OVAL TİP İĞNELİ OLMALIDIR.
- 4-FORSEPS KAPAKÇIKLARI EN AZ 6.7 MM GENİŞLİĞİNDE AÇILABİLMELİDİR.
- 5-FORSEPS KAPAKÇIKLARI KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.
- 6-FORSEPS ŞAFTI PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP ÜZERİ KAPLI OLMALIDIR.
- 7-KATETER KAPLAMASI ÜZERİNDE POZİSYONLANDIRMA MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-2.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 9-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.



Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007


Prof. Dr. Şehnem GÜRSOY
İç Hastalıkları A.D. Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. No: 84006 - İht. No: 54214
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

