

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
31.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **KAN MERKEZİNE** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ŞEFFAF FLASTER 5 CM X 10 METRE	200 ADET	
2	KAN IŞINLAMA ENDİKATÖRÜ	3000 ADET	
3	PLAZMA SAKLAMA KUTUSU	10.000 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **06.09.2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

2022 YILI
KAN MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

01.SIRA ŞEFFAF FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 5 cm. eni X 10 m.uzunluğu olmalıdır. Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı bırakmamalıdır.
2. Ciltten kaldırılması gerektiğinde ıslatılmadan çıkartılabilmelidir.
3. Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli ve alerjiye sebep olmamalıdır.
4. Flasterin yapışkanı sentetik polimerik akrilattan olmalıdır.


02.SIRA KAN IŞINLAMA ENDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme etiket şeklinde olup radyasyona duyarlı özel bir film içermelidir.
2. Işınlanacak kan torbalarının üzerine yapıştırılmalı ve ışınlama prosesinin kontrolünü ve güvenilirliğini sağlamalıdır.
3. Kan torbasının yeterli doz ışın aldığını gösteren, etiketin film bölümünde renk değiştiren uyarıcı yazı ya da işaret olmalıdır.
4. Etiketler üzerindeki son kullanma tarihine kadar, ışınlanarak veya ışınlamadan saklama aşamasında, ışınlama dışında başka ışık kaynaklarından etkilenmemelidir.
5. Etiket yapışkan özelliği yüksek olmalı; torbanın üzerinden kolayca sökülmemelidir.
6. ISBT128 koşullarında üretilmiş olmalı ve bunu belgelerle ispatlamalıdır.
7. 25Gy ışınlama düzeyine uygun olmalı, bu düzey ve üzeri ışınlama yapıldığında değişecek bir göstergesi (renk değişimi vs. gibi) olmalıdır.
8. Gerek duyulması halinde, ilgili firma ürünlere ilave olarak ışınlama sırasında ısı değerini kontrollerde kullanılacak 40 adet ısı kontrol etiketini ve cihazını ücretsiz karşılamalıdır.
9. Firma; indikatörlerin geçerliliği olan ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren **CE veya FDA** belgesinden en az birinin teklif dosyasına koymalıdır. Dosyada bu belge bulunmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.
10. Her kutu içerisinde etiketlerin ısıdan etkilenip etkilenmediğini gösteren ısı indikatörü olmalıdır.

04. SIRA PLAZMA SAKLAMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plazmaların saklanması ve transferinde esnasında yırtılmamalı. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Dış yüzeyi kartondan yapılmış olmalıdır.
3. Dış yüzeyinde kan merkezimiz amblemi ve yazısı olmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet YAKAR
Erişkes Ünlü Kan Merkezi
Genel Sorumlusu

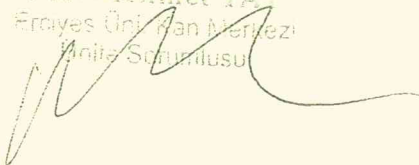

Prof. Dr. Ekrem ÜNAL
Kan Merkezi Sorumlusu

