

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
22/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ÜROLOJİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TUR SETİ PUARLI	500 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

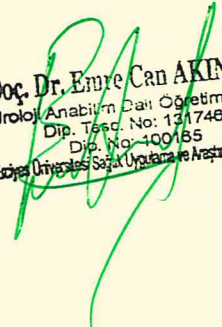
NOT: Teklif mektuplarının **en geç 06/10/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr
Fax:0 352 437 52 88

Y TİPİ TUR SETİ (PUARLI ATROSKOPİ SETİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Delici uçlar Y tipinde ve hava girişsiz olmalıdır.
2. Delici uçların sterilizasyon poşetine zarar vermemesi için her iki uçta da kapak bulunmaktadır.
3. Üzerinde en az 3 adet klemp bulunmalıdır.
4. Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.
5. Uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
6. Malzeme üzerinde 5 yıllık sterilizasyon tarihi olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde, kullanılan PVC maddesinin içinde ftalat olduğunu belirtir simge bulunmalıdır.
8. Y tipi tur setinin cihaz girişi ana hortumdan daha yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Cihaza giren yumuşak hortum ucunda konnektör bulunmalıdır.
10. Puar kısmı en az 100cc olmalıdır, yumuşak materyalden yapılmış olmalıdır, solüsyonun geri dönmemesi için puarın her iki ucunda çek valf bulunmalıdır.


Doç. Dr. Numan BAYDIL
Üroloji Uzmanı
Dip. No: 3539 Tescil No: 135990
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. Emre Can AKINSAL
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dip. Tescil No: 131748
Dip. No: 100185
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi