

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
01.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **TIBBİ SARF ANA MALZEME DEPOSU** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EMEÇ	20 PAKET	
2	SAHLİ HEMOMETRESİ	8 ADET	
3	HEMOGLOBİN PİPETİ LAB	5 ADET	
4	HEMOGLOBİN TÜPÜ	1 ADET	
5	ANTİ A KAN GRUBU	4 ADET	
6	ANTİ B KAN GRUBU	4 ADET	
7	ANTİ D KAN GRUBU	4 ADET	
8	TEK KULLANIMLIK AĞIZLIK	1 ADET	
9	PATCH CLAMP GLASS	1 ADET	
10	BAKTERİ FİLTRESİ	3 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		

A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **08/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

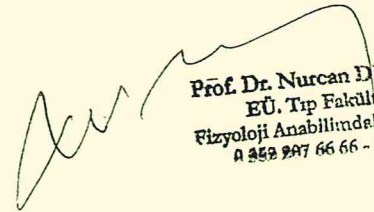
gecebli malzeme teknik şartnamesidir.

Sıra no	Miktar	Birim	Tanımı	Teknik şartname
1.	20	paket	Emeç	Şeffaf silikondan yapılmış olmalıdır. Dış çap 5.5 mm İç çap 3.5 mm olmalıdır. Uzunluğu 16 cm olmalıdır.
2.	8	adet	Sahli hemometresi	Karton kutu içerisindeki ölçüm seti, 2 farklı renkte opal camlı PS plastik taban, karşılaştırma tüpü, 20 ul'lık bir hemoglobın pipeti, yaklaşık 16 cm uzunluğunda silikon hortum ve beyaz ağızlık, damlatma pieti ve puarı, karıştırma çubuğu, temizleme fırçası ve asit şişesi içermelidir.
3.	5	adet	Hemoglobın pipeti	Sahli hemometresi ile hemoglobın ölçümünde kullanılacaktır. Üzeri 20 ul olarak işaretlenmiş cam malzemeden yapılmış olacaktır.
4.	1	adet	Hemoglobın tüpü	Sahli hemometresinde kullanıma uygun olmalıdır.
5.	12	adet	Kan grubu antiörorları	Klasik lam metodu ile birer damla kan ve reaktif kullanarak standart kan grupları (A-B-AİB-0 ve Rh) nm saptanmasında kullanılabilmelidir. Anti A(Mavi), Anti B(Sarı) ve Anti D(Şeffaf) olarak renklendirilmiş reaktiflerle 150 civarında test sonucu doğru bir şekilde ve kısa zamanda her türlü laboratuvar koşullarında alınabilmelidir.
6.	1	Adet	Disp. mouthpiece	22 mm dış çapında olmalı Tek kullanımlık olmalı Üründe bakteriyel veya viral filtre olmalıdır.
7.	1	adet	Disp. Noseclip	Hava Akışı Dönüştürücüsünü kullanırken burun deliklerini nazikçe sıkarak kapatmalı
8.	1	adet	Disp. Bact. Filter	Gözenek Boyutu: Virüs Filtrasyon Verimliliği (VFE): 3.1 mikron; Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE): 2.8 mikron olmalıdır. 22 mm çapında olmalıdır.
9.	2	adet	Nerve chambers cables	BSL stimülatör ile sinir iletim çemberi arasında uyumlu olmalı. Altın kaplama olmalı. Uzunluğu 1.2 metre olmalı.

Can Fer

Prof. Dr. Nuran DURSUN
EÜ. Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
0 352 207 66 66 - 23396

10.	3	adet	Patch clamp glass 1,5/1,0mm. WPI. PG52151-4	Borosilikat yapıda olmalı Dış çapı 1,5 mm iç çapı 1,0 mm olmalı Septum içermemeli.
11.	1	adet	Human RO Pack	Kartuş, Human marka New Human Power 1 model cihaza uyumlu olmalıdır. Kartuş, iyon filtresi ve RO çeperinden oluşmalıdır. Ön filtrelerden geçip RO kartuşunda üretilen suyun kalitesi 0,2 -30 µs/cm olmalıdır. Kartuş, cihaza her hangi bir alet kullanılmadan sökülüp takılabilmelidir. Kartuşun ömrü besleme suyunun kalitesine göre 12-18 ay arası olmalıdır.
12.	1	1	Power UP Pack(S-UV)	Lamba, Human marka New Human Power 1 model cihaza uyumlu olmalıdır. Lamba, bakteri ve TOC düzeyini minimuma indirebilmek için 185 ve 254 nm`de UV foto oksidasyon sağlamalıdır. Lambanın ömrü en az 2000 saat olmalıdır.


Prof. Dr. Nurcan DURSUN
 EÜ. Tıp Fakültesi
 Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 0 352 287 66 66 - 23306