

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
15.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GASTROENTEROLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BİLİYER DİLATASYON BALONU (12-13-5- 15 MM KADEMELİ)	4 ADET	
2	BİLİYER DİLATASYON BALONU (10-11-12 MM KADEMELİ)	4 ADET	
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **21/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

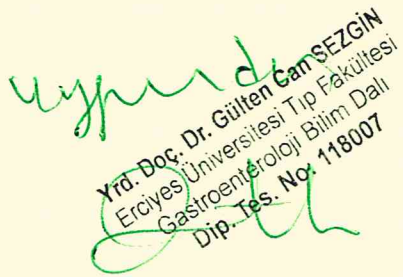
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

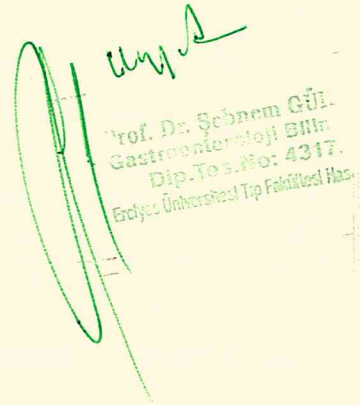
1-BİLİARY DİLATASYON BALONU KADEMELİ 12-13,5-15 MM

- 1-BALON KATETERİ İÇERİSİNDE İSTENİLDİĞİNDE ÇIKARILABİLİR 0.035 HİDROFİLİK KAPLI KILAVUZ TEL BULUNMALIDIR.
- 2-KATETER UZUNLUĞU EN AZ 180 CM OLMALIDIR.
- 3-KATETER ÇAPI 7 F OLMALIDIR.
- 4-KATETERİN BALONDAN SONRAKİ UÇ KISMI SİLİKONDAN MAMÜL OLUP DOKUYA ZARAR VERMEYECEK YUMUŞAKLIKTA OLMALIDIR.
- 5-2.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 6-UCU İNCELEREK SONLANMALIDIR.
- 7-BALONUN HER İKİ UCUNDA FLOROSKOPİ ALTINDA GÖRÜLEBİLİR RADYOOPAK MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-BALON KADEMELİ OLARAK ŞİŞİRİLEBİLMELİDİR.
- 9-BALON ÇAPI 6-7-8 MM OLMAK ÜZERE KADEMELİ OLMALIDIR.
- 10-BALON UZUNLUĞU EN FAZLA 30 MM OLMALIDIR.
- 11-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
- 12- ÜRÜN KATETERİ ÜZERİNDE BALON ÇAPLARI SİLİNMEYECEK BİR ŞEKİLDE YAZILI OLMALIDIR.

2-BİLİARY DİLATASYON BALONU KADEMELİ 10-11-12 MM

- 1-BALON KATETERİ İÇERİSİNDE İSTENİLDİĞİNDE ÇIKARILABİLİR 0.035 HİDROFİLİK KAPLI KILAVUZ TEL BULUNMALIDIR.
- 2-KATETER UZUNLUĞU EN AZ 180 CM OLMALIDIR.
- 3-KATETER ÇAPI 7 F OLMALIDIR.
- 4-KATETERİN BALONDAN SONRAKİ UÇ KISMI SİLİKONDAN MAMÜL OLUP DOKUYA ZARAR VERMEYECEK YUMUŞAKLIKTA OLMALIDIR.
- 5-2.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 6-UCU İNCELEREK SONLANMALIDIR.
- 7-BALONUN HER İKİ UCUNDA FLOROSKOPİ ALTINDA GÖRÜLEBİLİR RADYOOPAK MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-BALON KADEMELİ OLARAK ŞİŞİRİLEBİLMELİDİR.
- 9-BALON ÇAPI 8-9-10 MM OLMAK ÜZERE KADEMELİ OLMALIDIR.
- 10-BALON UZUNLUĞU EN FAZLA 30 MM OLMALIDIR.
- 11-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
- 12- ÜRÜN KATETERİ ÜZERİNDE BALON ÇAPLARI SİLİNMEYECEK BİR ŞEKİLDE YAZILI OLMALIDIR.


Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007


Prof. Dr. Şebnem GÜL
Gastroenteroloji Bilim
Dip. Tes. No: 4317
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.