

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
15.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ÜROLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TEK KULLANIMLIK FLEKSİBL SİSTOSKOP	6 ADET	
2	MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ (RULO)	50 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYENLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **29/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.


Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88


TEK KULLANIMLIK DIGITAL VIDEO FLEXIBLE SİSTO/NEFROSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık Digital Video Flexible Sisto/Nefroskop Mesane bölgesinde Ürolojik tanı, Biyopsi alma işlemlerine yönelik kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tek kullanımlık Digital Video Flexible /Nefroskop, Video prosesor ile birlikte Esnek görüntüleme endoskop'tan oluşmalıdır.
3. CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip olmalıdır.
4. Görüş alanı 120° olmalıdır.
5. Çalışma uzunluğu 38 cm olmalıdır.
6. Alan derinliği 0.5-120mm olmalıdır.
7. Distal uç çapı kalınlığı 5.2mm, Şaft çapı 5.4mm olmalıdır.
8. Çalışma kanalı çapı 6,6 Fr. (2,2mm) olmalıdır.
9. Aşağı ve yukarı defleksiyon açısı UP 220° / Down 220° olmalıdır.
10. Digital Video Flexible Sisto/Nefroskop Tutaç kısmı hafif ve ergonomik yapıda olup, hekime farklı açılarda tutma ve kullanma imkânı sağlamalıdır.
11. Flexible Sisto/Nefroskop tutaç kısmında çalışma kanalı haricinde farklı bir Aspirasyon kanalı olmalıdır, kanaldan aspirasyon yardımı ile Mesane içerisindeki su basıncını düşürmek, taş, partikül vb. gibi yabancı cisimlerin dışarıya alınmasına yardımcı olan kanal ve tolibors'a sahip olmalıdır.
12. Flexible Sisto/Nefroskop'un şaft kısmında bulunan rotasyon özelliği olmalıdır. Her iki yöne $\pm 60^\circ$ açılanma yapabilmelidir.
13. Video işlemci cihazı Led aydınlatma sistemi içerisinde olmalıdır.
14. Video işlemci cihazının üzerinde butonlar olmalıdır, Butonlar; Cihaz açma/kapama, Beyaz ayarı (White balance), Gain (Görüntü kontrast ayarı), Freeze (Görüntü dondurma), Zoom (Görüntü boyutu büyütme/küçültme), LED (Üç seviyeli ayarlanabilir aydınlatma), GAIN (kılcal damarları tespit etme ve üst sistem tümörlerini tespit edebilme), Record and Photo (Video ve Fotoğraf kaydı alabilme, USB girişi (Kayıt sistemi için), Output (DVI*1, SDI*2 ile görüntü çıkışı), Ayak pedalı bağlantı girişi.
15. Video işlemci cihazında EGDE özelliği olmalıdır, Bu özellik sayesinde Üst üriner sistem ve mesanede tümörleri tespit edebilme ve gelişmiş görünürlük nedeniyle yapı bozuklukları olan dokuların görüntülenmesine olanak sağlamalıdır.
16. Video işlemci cihazında USB kayıt yapabilir olmalıdır, herhangi bir kayıt cihazına ihtiyaç duymadan MPEG4/JPEG formatlarında resim, video kaydedebilmelidir.
17. Tek kullanımlık Flexible Ureterorenoskop paketinin içerisinde 1 adet Y Tolibors (Stopper), 1 adet Standart Tolibors (Stopper) olmalıdır.
18. Video işlemci Flexible Uretero-renoskop alımına istinaden konsinye olarak verilmelidir. Flexible Ureterorenoskop kullanımı sürdükçe mülkiyeti satıcı firma tarafında kalacak olup Video işlemci kullanıma bırakılacaktır.
19. Video işlemci cihazında aynı marka Tek kullanımlık Flexible Ureterorenoskop cihazı kullanıma olanak sağlamalıdır.
20. Cihazlar ile beraber aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir;
 - a. Video İşlemci güç kablosu
 - b. SD Kart 16 GB
 - c. İşlemci görüntü aktarım kablosu DVI
21. Teklif verecek firmalar demo çalışması yapmak zorundadır. Demo çalışmasından sonra karar verilecektir.
22. Demo çalışması yapmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doç. Dr. Emre Can AKINSAL
Üroloji Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi

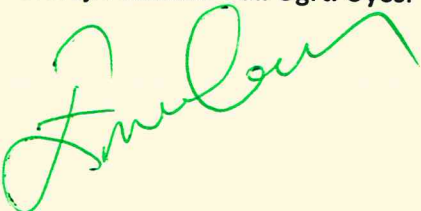

Doç. Dr. Numan BAYDİLLİ
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

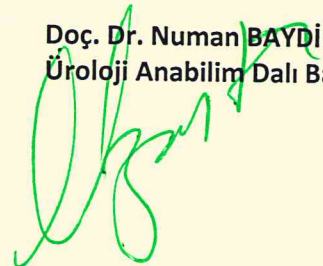

MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ (RULO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Muayene masa örtüleri sıvıyı altına geçirmemelidir,
- 2-Laminasyon kağıttan ayrılmamalıdır,
- 3-Her rulo ayrı ayrı ambalajlanıp koli içerisine konmalıdır,
- 4-Koli üzerinde koli iç miktarı toplam metre ve teknik bilgiler yer almalıdır,
- 5-ISO 9001/2008 kalite standartlarına uygunluk belgesi olmalıdır
- 6-Ürünün TSE/TSEK belgesi olmalıdır
- 7-Ürünün UBB kaydı olmalıdır
- 8-Değerlendirme için yeteri kadar numune teslim edilmeli,Numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır,
- 9-Numune,katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir,
- 10-Teknik şartnamada belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir,
- 11- 50cm x 50 cm ölçülerinde, Perfore aralığı 50 cm olmalıdır,
- 12-Rulo sarımı düzgün olmalıdır,
- 13-Bir rulo en az 100 yaprak olmalıdır,
- 14-Laminasyon rengi opak beyaz olmalıdır ve antialerjik özellikte olmalıdır
- 15-Perforajlar belirgin düzgün kopabilecek şekilde olmalıdır,


Doç.Dr. Numan BAYDILLI
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. No: 3999/Tescil No: 135990
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri