




## PASLANMAZ SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Serum askısının gövdesi 42 mm çapında, taşıyıcı borusu 32 mm çapında paslanmaz çelik borudan imal edilmelidir.
- 2- Serum askısı dört adet serum kancasına sahip olmalıdır. Kancanın ucu dairesi olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
- 3- Serum askısının yüksekliği 1200- 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır. Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için vida sistemi bulunmalıdır.
- 4- Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.
- 5- Ayak bölümünde beş adet tekerlek bulunmalıdır.
- 6- Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini olmalıdır.
- 7- Üretici firmanın TSE ve ISO sertifikası olmalıdır.
- 8- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlıđından onaylı satış sonrası hizmete yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

### ÜRÜN GÖRSELİ

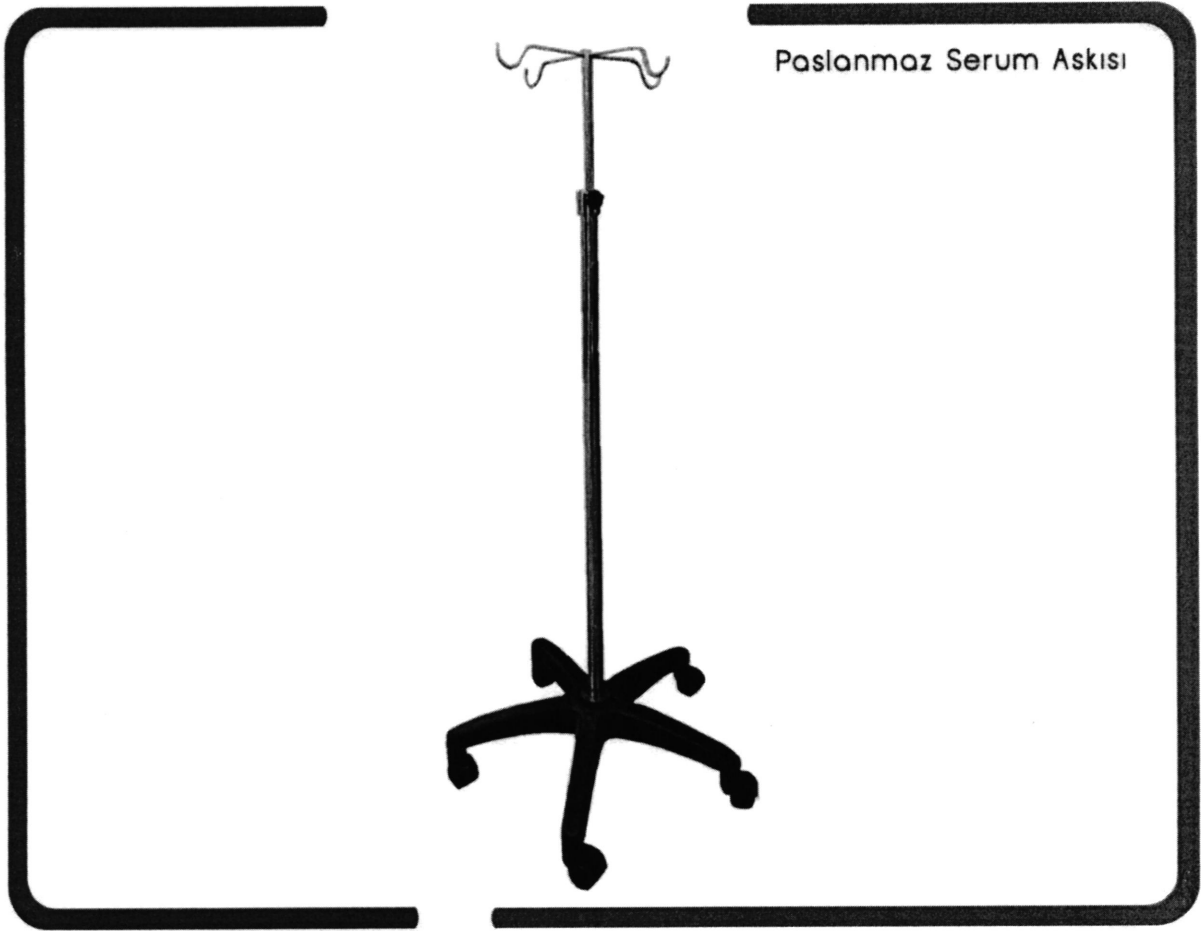

Prof. Dr. İsmail KOCYİĞİT  
İç Hastalıkları - Nefroloji B.  
Etiler Üniv. Tıp Fakültesi Hastaneüstü