

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
10/01/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında


Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	DİYALİZ HASTANESİ KROM NİKEL TEZGAH YAPIMI	1 ADET	
2	YEMEKHANE TAŞIMA ARABASI YAPIMI	1 ADET	
3	YEMEKHANE KORKULUK YAPILMASI	1 ADET	
	BİLGİ İÇİN KAYNAK ATÖLYESİ : ALİ CAYMAZ		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20090		
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 21/01/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

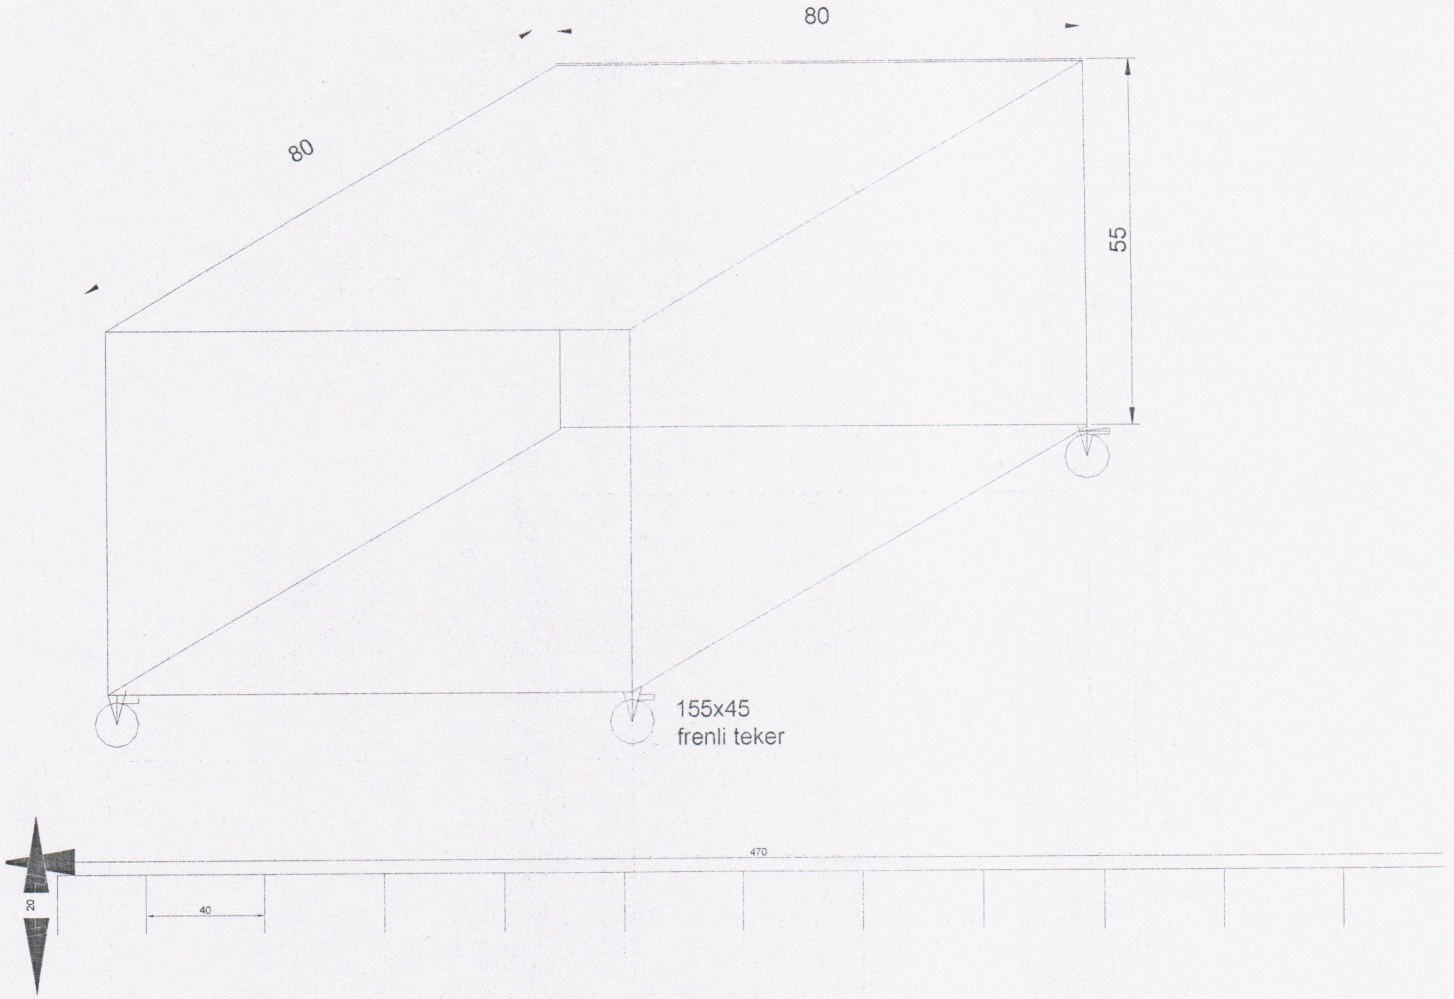

TAŞIMA ARABASI VE KORKULUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm malzemeler 304 kalite krom-nikelden üretilecektir.
2. Araba tekerleri 155x45 ebatların da ve frenli, rulmanlı olacaktır.
3. Araba isleler kısmı 40x40x1.2 mm kutu profilden olacaktır.
4. Araba üst kısımları 1.2 mm sacdan olacaktır.
5. Korkuluk 32'li ve 1.5 mm et kalınlığında borudan üretilecek ve 40 cm aralıklarla yerlere angrajlanacaktır.

Ali CAYMAZ
Metal Teknolojileri Tekn.
E.O. Hastahaneleri Teknik Bakım Ünitesi

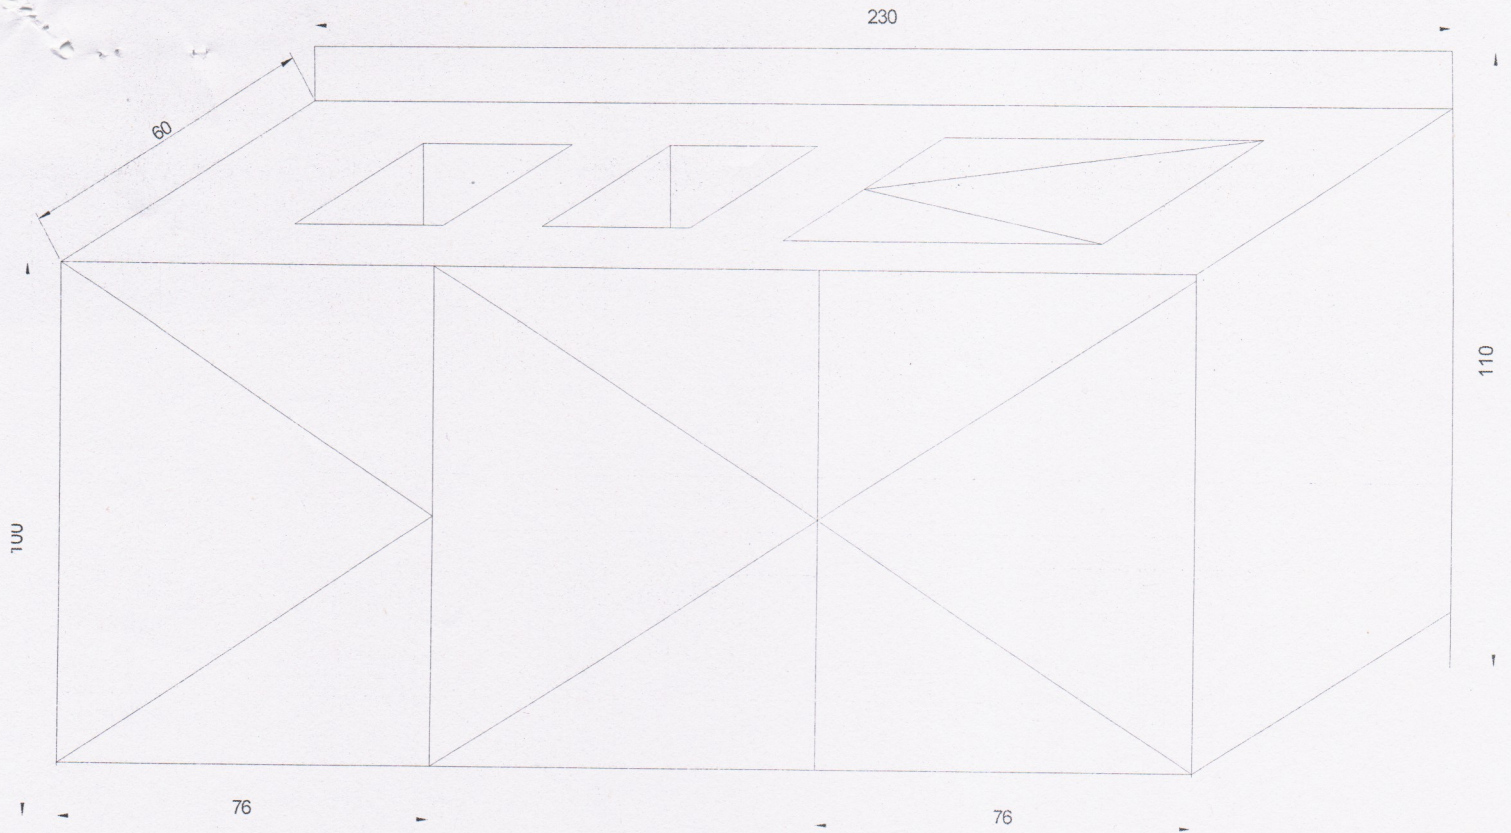

PERİTON DİYALİZ ÜNİTESİ KROM-NİKEL TEZGÂH ŞARTNAMESİ

1. Tezgâh 304 kalite krom nikel malzemeden üretilecektir.
2. 1.2 mm et kalınlığında sacdan üretilecektir.
3. Tezgâh üst kısmında 2 adet lavabo yeri ve bir adet kapak bulunacaktır.
4. Ayaklar 40x40 mm yaralanabilir pabuçtan olacaktır.
5. Tezgâh alt kısmında 3 adet kapak kullanılacak ve kulpları ay koldan olacaktır.
6. Eviye ve musluk kısımları standart su gider ve musluk çaplarında delinecektir.

Ali CAYMAZ
Metal Teknolojileri Tekn.
E.Ü. Hastaneleri Teknik Bakım Ünitesi